スマイルキュート 取扱説明書より抜粋

修理をご依頼される前に

動作確認チェックリスト

修理をご依頼される前に、以下の事項を見直してください。

症状	原因	処置方法	参照
専用ACアダプターのLEDが点灯しない	専用ACアダプターは正しく接続されていますか？	専用ACアダプター本体に電源コードをしっかり差し込んでください。	P9
	コンセントに電気はきていますか？	電気のきているコンセントを使用してください。	–
	コードが断線またはアダプター本体の故障が考えられます。	専用ACアダプターの交換が必要です。 アダプター本体が高温になっている場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。	P26
吸引ポンプが作動しない	指定の専用ACアダプターを使用していますか？	指定の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。	–
	ヒューズは切れていませんか？	ヒューズを交換してください。	P22
	別売の専用充電池をご使用の場合、充電を行いましたか？	専用充電器付属の取扱説明書に従い、充電を行ってください。	P23
	製品の稼動時間は2,000時間を超えていませんか？	吸引ポンプ(モーター)の寿命は使用環境などによって大きく異なりますが、約2,000時間です。 内部機器には触れず、お買い上げの販売店もしくは新鋭PSセンターにお問い合わせください。	背表紙
	上記以外の原因	吸引ポンプの故障など内部の異常が考えられます。 内部機器には触れず、お買い上げの販売店もしくは新鋭PSセンターにお問い合わせください。	背表紙
吸引ポンプは作動するが吸引しない または 吸引力が弱い	吸引ポンプの作動不良またはリーク(空気漏れ)が考えられます。	吸引瓶を取り外し、調節弁ツマミを(H)の方向に回した状態で吸引ポンプを作動させ、図のように入口部(PUMP)を指で塞ぎます。 真空計の針が−80kPa程度を示せば、吸引ポンプに異常はありません。 本体外部でのリークが考えられますので、次のリーク確認チェックを行ってください。 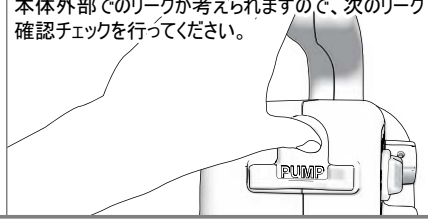	P18

リーク確認チェックリスト

修理をご依頼される前に、以下の事項を見直してください。

チェック項目	処置方法	参照
吸引瓶は本体に正しく取り付けられていますか？	奥まで入れ直してください。	P16
吸引瓶パッキンは、正しく取り付けられていますか？	下記(吸引瓶パッキンの取り付け方)を参考に、正しく取り付けてください。 汚れている場合は洗浄してください。	P16 P18
吸引瓶キャップは、吸引瓶にしっかり取り付けていますか？	最後までしっかり締め付けてください。	P16
ホースロにOリングを、正しく取り付けられていますか？また、亀裂など入っていませんか？	Oリングを確認してください。 亀裂など破損している場合は、部品の交換が必要です。	P26
吸引瓶キャップや、吸引瓶などに亀裂が入っていませんか？	亀裂など破損している場合は、部品の交換が必要です。	P26
上記以外の原因	内部機器には触れず、お買い上げの販売店もしくは新鋭PSセンターにお問い合わせください。	背表紙

吸引瓶パッキンの取り付け方

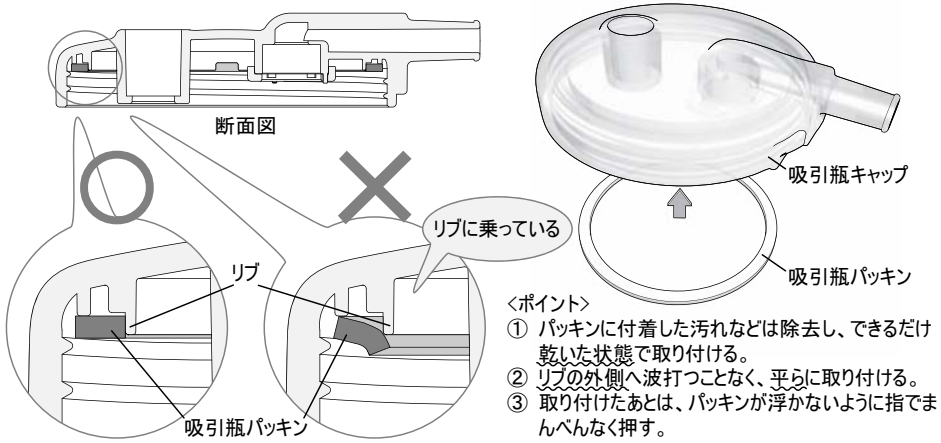

〈ポイント〉
① パッキンに付着した汚れなどは除去し、できるだけ乾いた状態で取り付ける。
② リブの外側へ波打つことなく、平らに取り付ける。
③ 取り付けたあとは、パッキンが浮かないように指でまんべんなく押す。

⚠警告

分解禁止

●絶対に分解や改造は行わないこと。
発火や感電、けがのおそれがあります。

⚠警告

電源プラグを抜く

●本器に異常を感じられた場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。専用充電池を接続しているときは、安全を確認してから取り外すこと。